

Dit genopladelige høreapparat

Brugervejledning



Genopladelige produkter
mRIC R (Mikro højtaler-i-kanalen)
genopladelig.

RIC RT (Højtaler-i-kanalen)
Genopladelig med telespole.

Warnings, Cautions, & Notices

REQUIRED HEARING AID INFORMATION

The following additional information is provided in compliance with U.S. Food and Drug Administration (FDA) regulations:

WARNING: People younger than 18 should go to a doctor before using this.

People younger than 18 years old need specialized care, and using this without a medical evaluation may worsen impairment or disability. A hearing aid user who is younger than 18 should have a recent medical evaluation from a doctor, preferably an ear-nose-throat doctor (an ENT). Before using this, a doctor should determine that the use of a hearing aid is appropriate.

WARNING to Hearing Aid Dispensers:

You should advise a prospective hearing aid user to consult promptly with a doctor, preferably an ear specialist such as an ENT, before dispensing a hearing aid if you determine through inquiry, actual observation, or review of any other available information concerning the prospective user, that the prospective user has any of the following conditions:

- Visible deformity of the ear, either congenital or traumatic
- Fluid, pus, or blood coming out of the ear within the previous 6 months
- Pain or discomfort in the ear
- History of excessive ear wax or suspicion that something is in the ear canal
- Dizziness, either recent or long-standing
- Sudden, quickly worsening, or fluctuating hearing loss within the previous 6 months
- Hearing loss or ringing (tinnitus) only in one ear or a noticeable difference in hearing between ears
- Audiometric air-bone gap equal to or greater than 15 dB at 500 Hz, 1000 Hz, and 2000 Hz

WARNING to Hearing Aid Dispenser, Outputs over 132 dB SPL:

You should exercise special care in selecting and fitting a hearing aid with a maximum output that exceeds 132 dB SPL because it may impair the remaining hearing of the hearing aid user.

International Use

Your hearing aids are approved to operate at a radio frequency that is specific to your country or region and might not be approved for use outside your country or region. Be aware that operation during international travel may cause interference to other electronic instruments, or other electronic instruments may cause interference to your hearing aids.

Warnings, Cautions, & Notices

We are required by regulations to provide the following warnings:

 **WARNING:** Use of wireless hearing aids directly next to other electronic equipment should be avoided because it could result in improper performance. If such use is necessary, note as to whether your hearing aids and the other equipment are operating normally.

 **WARNING:** Use of accessories, components or replacement parts other than those provided by the manufacturer of your hearing aids could result in increased electromagnetic emissions and decreased electromagnetic immunity and could result in degradation of performance.

 **WARNING:** If Portable Radio Frequency communications equipment is used closer than 30 cm (12 inches) from your hearing aid, degradation of the performance of your hearing aid could result. If this occurs, move away from the communications equipment.

 **WARNING:** The stability of the hearing aid is designed for normal use. Avoid physical impacts to the ear when wearing a hearing aid that may cause the device to break or component of the device to become detached. This may lead to lacerations of the ear canal or perforation of the ear drum. If this occurs, it is strongly recommended to see a physician for evaluation and safe removal.

 **WARNING:** If the hearing aid drops onto a hard surface, it could cause the hearing aid to break or become damaged. This includes mechanical stress or shock of the device. Ensure the hearing aid is intact before placing it in the ear. If you find the device is damaged, discontinue use and see your hearing professional.

 **WARNING:** Repeated stress to the removal handle may cause it to break. If the removal handle breaks and you're unable to remove the device carefully, it is recommended to see a physician for safe removal.

WARNING TO HEARING CARE PROFESSIONAL

A hearing care professional should advise a prospective sound generator (tinnitus masker) user to consult promptly with a licensed physician (preferably an ear specialist) before using a sound generator if the hearing care professional determines through inquiry, actual observation or review or any other available information concerning the prospective user that the prospective user has any of the following conditions:

- Visible congenital or traumatic deformity of the ear
- History of active drainage from the ear within the previous 90 days
- History of sudden or rapidly progressive hearing loss within the previous 90 days
- Acute or chronic dizziness
- Unilateral hearing loss of sudden or recent onset within the previous 90 days

Warnings, Cautions, & Notices

⚠️ WARNING: There are some potential concerns associated with the use of any sound generating tinnitus therapy instrument. Among them are the potential for worsening of tinnitus, a possible change in hearing thresholds, and possible skin irritation at the point of contact with the hearing aid.

Multiflex Tinnitus Technology has been designed to minimize these concerns. However, should you experience or notice any of the above conditions or any dizziness, nausea, headaches or heart palpitations, you should immediately discontinue use of the hearing aid and seek a consultation with a medical, audiology or other hearing care professional.

As with any hearing aid, misuse of the tinnitus therapy instrument could present some potentially harmful effects. Care should be taken to prevent the unauthorized use and to keep the hearing aid out of the reach of children and pets.

FALL ALERT FEATURE

The Fall Alert feature can be used to notify others should you fall or experience a non-fall-related event. This feature can be configured to send an SMS text message to predefined contacts. Fall Alert can be configured to send automated and/or manually-initiated alerts.

⚠️ WARNING: Auto Alert may not detect 100 percent of falls

⚠️ WARNING: Decreasing the Auto Alert Sensitivity may prevent some falls from being detected by your Fall Alert system. For example, Auto Alert may not detect a fall if:

- The Sensitivity setting is not appropriate for the user
- The fall is very slow, or you slide down gradually
- You get up and begin walking immediately after a fall

⚠️ WARNING: Auto Alert may initiate false alerts. To prevent false-alert text messages from being sent to your contact(s), you may cancel the alert from either your smartphone or by pressing the user control on either hearing aid.

⚠️ WARNING: To reduce Fall Alert communication failures:

- Your hearing aid(s) need to be powered on, paired and connected with your smartphone using Bluetooth® connectivity
- The mobile device must be powered on, with the hearing aid mobile app open (in the foreground or background)
- The mobile device must have a connection to the Internet (via a cellular network or WiFi)

⚠️ CAUTION: This is not hearing protection.

You should remove this device if you experience overly loud sounds, whether short or long-lasting. If you're in a loud place, you should use the right kind of hearing protection instead of wearing this device. In general, if you would use ear plugs in a loud place, you should remove this device and use ear plugs.

Warnings, Cautions, & Notices

⚠️ CAUTION: The sound output should not be uncomfortable or painful.

You should turn down the volume or remove the device if the sound output is uncomfortably loud or painful. If you consistently need to turn the volume down, you may need to further adjust your device.

⚠️ CAUTION: You might need medical help if a piece gets stuck in your ear.

If any part of your hearing aid, like the eartip, gets stuck in your ear, and you can't easily remove it with your fingers, get medical help as soon as you can. You should not try to use tweezers or cotton swabs because they can push the part farther into your ear, injuring your eardrum or ear canal, possibly seriously.

NOTE: What you might expect when you start using a hearing aid.

A hearing aid can benefit many people with hearing loss. However, you should know it will not restore normal hearing, and you may still have some difficulty hearing over noise. Further, a hearing aid will not prevent or improve a medical condition that causes hearing loss.

People who start using hearing aids sometimes need a few weeks to get used to them. Similarly, many people find that training or counseling can help them get more out of their devices.

If you have hearing loss in both ears, you might get more out of using hearing aids in both, especially in situations that make you tired from listening—for example, noisy environments.

NOTE: Tell FDA about injuries, malfunctions, or other adverse events.

To report a problem involving your hearing aid, you should submit information to FDA as soon as possible after the problem. FDA calls them "adverse events," and they might include: skin irritation in your ear, injury from the device (like cuts or scratches, or burns from an overheated battery), pieces of the device getting stuck in your ear, suddenly worsening hearing loss from using the devices, etc.

Instructions for reporting are available at <https://www.fda.gov/Safety/MedWatch>, or call 1-800-FDA-1088. You can also download a form to mail to FDA.

NOTE: Hearing loss in people younger than 18.

- People younger than 18 should see a doctor first, preferably an ear-nose-throat doctor (an ENT), because they may have different needs than adults
- The doctor will identify and treat medical conditions as appropriate
- The doctor may refer the person to an audiologist for a separate test, a hearing aid evaluation
- The hearing aid evaluation will help the audiologist select and fit the appropriate hearing aid

Warnings, Cautions, & Notices

A person who is younger than 18 years old with hearing loss should have a medical evaluation by a doctor, preferably an ENT, before buying a hearing aid. The purpose of a medical evaluation is to identify and treat medical conditions that may affect hearing but that a hearing aid won't treat on its own.

Following the medical evaluation and if appropriate, the doctor will provide a written statement that the hearing loss has been medically evaluated and the person is a candidate for a hearing aid. The doctor may refer the person to an audiologist for a hearing aid evaluation, which is different from the medical evaluation and is intended to identify the appropriate hearing aid.

The audiologist will conduct a hearing aid evaluation to assess the person's ability to hear with and without a hearing aid. This will enable the audiologist to select and fit a hearing aid for the person's individual needs. An audiologist can also provide evaluation and rehabilitation since, for people younger than 18, hearing loss may cause problems in language development and educational and social growth. An audiologist is qualified by training and experience to assist in the evaluation and rehabilitation of hearing loss in people younger than 18.

IMPORTANT NOTICE FOR PROSPECTIVE Rx HEARING AID USERS:

It is good health practice for a person with a hearing loss to have a medical evaluation by a licensed physician (preferably a physician who specializes in diseases of the ear) before purchasing a prescription hearing aid. Licensed physicians who specialize in diseases of the ear are often referred to as otolaryngologists, otologists or otorhinolaryngologists. The purpose of the medical evaluation is to assure that all medically treatable conditions that may affect hearing are identified and treated before the hearing aid is purchased.

Following the medical evaluation, the physician will give you a written statement that states that your hearing loss has been medically evaluated and that you may be considered a candidate for a hearing aid. The physician will refer you to an audiologist or hearing aid dispenser, as appropriate, for a hearing aid evaluation.

The audiologist or hearing aid dispenser will conduct a hearing aid evaluation to assess your ability to hear with and without a hearing aid. The hearing aid evaluation will enable the audiologist or dispenser to select and fit a hearing aid to your individual needs.

If you have reservations about your ability to adapt to amplification, you should inquire about the availability of a trial-rental or purchase option program. Many hearing aid dispensers now offer programs that permit you to wear a hearing aid for a period of time for a nominal fee after which you may decide if you want to purchase the hearing aid.

In some geographies, you must have a medical evaluation before purchasing a prescription hearing aid. Some States allow an adult to waive the medical evaluation.

Warnings, Cautions, & Notices

A hearing aid will not restore normal hearing and will not prevent or improve a hearing impairment resulting from organic conditions. Use of a hearing aid is only part of hearing habilitation and may need to be supplemented by auditory training and instruction in lip reading. In most cases infrequent use of a hearing aid does not permit a user to attain full benefit from it.

Some hearing instrument users have reported a buzzing sound in their hearing instrument when they are using mobile phones, indicating that the mobile phone and hearing instrument may not be compatible. It is well-known that mobile phones are potential sources of noise for hearing aids. Your Starkey Hearing Aids have been tested for compliance to two standards that define hearing aid immunity to digital wireless devices and meet the requirements of ANSI C63.19-2019 as well as the criteria for user compatibility as defined by IEC 60118-13:2019.

⚠ CAUTION: The following are potential physiological side effects from use of hearing aids. Consult a physician if the following occur:

- Worsening of Hearing Loss or Tinnitus
- Pain or Discomfort from heat (burns), abrasion (cuts and scratches), infection, shock
- Dermal Allergic Reaction (inflammation, irritation, swelling, discharge)
- Excessive production of cerumen (Earwax)

Tillykke!

Dit bedste liv begynder med bedre hørelse.

Introduktion af dine nye høreapparater.

Brug denne brugervejledning til at lære dine høreapparater at kende - og få mest muligt ud af din høreoplevelse.

Når du hører bedre, lever du bedre.
Takket være dine nye høreapparater.

Vidste du, at du kan få adgang til flere funktioner med din mobiltelefon? Se vejledningen:

Opsætning af Min App for flere informationer.

I denne Manual

Følgende høreapparatmodeller
indgår i denne vejledning (vælg
dit høreapparat):

- mRIC R



- RIC RT



Serienummer

Venstre: _____

Højre: _____

Dine høreapparater indeholder et indbygget, genopladeligt
lithium-ion-batteri, der ikke kan fjernes.

Indholdsfortegnelse

1. Warnings, Cautions, & Notices	2
2. Forberedelse og brug	
Funktioner, Kontroller og Identifikation	14
Brug	16
Pleje af Høreapparat	25
3. Fejlfinding	32
4. Yderligere vejledning	
Intended use	36
FCC information	40
Lovmæssig information	41


Forberedelse og Brug

- Funktioner, Kontroller
og Identifikation
- Brug
- Pleje af Høreapparat


Funktioner, Kontroller og Identifikation

Oversigt

1. Ledning
2. Mikrofoner
3. Brugerkontrol mRIC R: Trykknap
RIC RT: Vippeknap
4. Receiver (højtaler)
5. Voksfilter
6. Producentens navn, model og serienummer
7. Opladningskontakter
8. Højre-/Venstreindikator
RØD er for **højre øre**, **BLÅ** er for **venstre øre**
9. Støttesnor til fastholdelse (valgfri)
10. Receivernes højre/venstre indikatorer
RØD er for **højre øre**, **BLÅ** er for **venstre øre**
11. Øreprop
12. Brugertilpasset øreprop (valgfri)
13. Brugertilpasset power øreprop (valgfri)

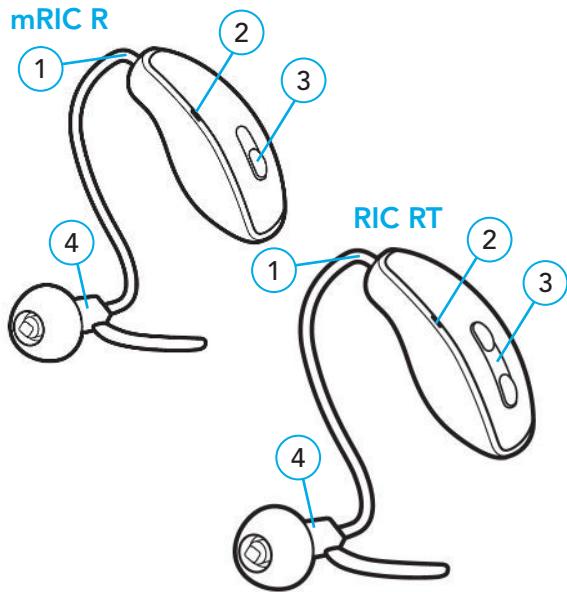

NOTE: Nedenstående illustrationer er gældende for mRIC R og RIC RT.

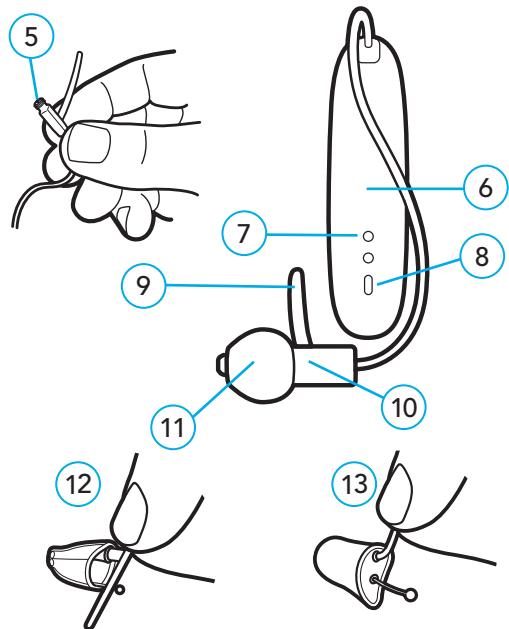

Brug

STEP 1: Oplad dine høreapparater

Vælg din oplader:

StarLink Oplader


StarLink Premium Mini Oplader

Før du bruger dine høreapparater første gang, skal du oplade dem helt. Se *brugsanvisningen til StarLink oplader*.


Brug

STEP 2: Tag dine høreapparater på

1. Tag dit høreapparat fra opladeren. Placér høreapparatet bag øret, så ledningen og øreproppen hænger foran øret.



2. Vip hånden let fremad, og indsæt forsigtigt tippen af proppen i øregangen (for ørepropper, tryk forsigtig på plads med fingerspidsen) indtil ledningen sidder fladt mod hovedet.

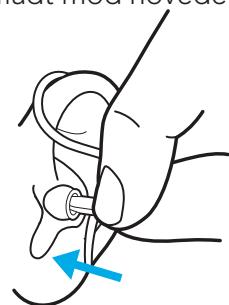


Brug

3. Anbring støtten så den følger ørets form. Spidsen skal bøje mod bagsiden af dit hovede. Færdig!




STEP 3: Tag dine høreapparater af

1. Fjern støtten fra øreskålen. Tag fat i ledningen med tommel- og pegefingeren, og træk forsigtigt ørepropsten ud.

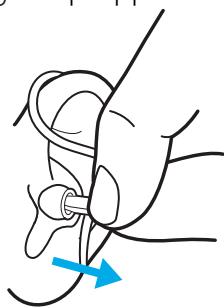

Brug

2. Fjern høreapparatet fra bagsiden af øret.

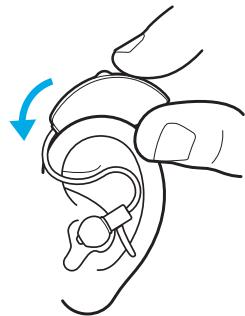

Power ON/OFF

Der lyder en indikator når høreapparatet **tændes (ON)** og **slukkes (OFF)**.

- **ON** indikator – en række toner, der stiger i tonehøjde.
- **OFF** indikator – en række toner, der falder i tonehøjde.

Tænd/sluk for dine høreapparater ved brug af opladeren eller knapperne på høreapparatet. Se tabellen på næste side.

Brug

	TÆND	SLUK
Oplader	<p>Dine høreapparater tænder automatisk når du tager dem op af laderen.</p> <p>De tænder med en lille forsinkelse, så du kan nå at tage dem i ørerne.</p>	<p>Dine høreapparater slukker automatisk når de placeres i laderen.</p>
Brugerkontrol (mRIC R: Trykknap)	<p>Hvis du har slukket høreapparatet ved at trykke på knappen kan du tænde det igen ved at holde knappen inde.</p> <p>De tænder med en lille forsinkelse, så du kan nå at tage dem i ørerne.</p>	<p>Du kan slukke apparaterne manuelt ved at holde knappen inde i 3 sekunder, medmindre andet er aftalt med din hørespecialist.</p>

Brug

Forventet batterilevetid

Batterilevetiden varierer afhængigt af mængden af streaming:

- **mRIC R**

- Uden streaming: Op til 41 timer
- Med streaming: Op til 33 timer

- **RIC RT**

- Uden streaming: Op til 51 timer
- Med streaming: Op til 45 timer

Brugerkontrol

Med brugerkontrol kan du styre dine høreapparater manuelt. Dine brugerkontroller indstilles af din hørespecialist, som også kan aktivere knapperne på dine høreapparater.

Din brugerkontrol fungerer på 3 måder:

- **Kort tryk:** Tryk på knappen i 1 sekund og slip derefter.
- **Langt tryk:** Tryk og hold knappen nede i 3 sekunder eller mere.
- **Tap kontrol:** Dobbelttap på eller i nærheden af knappen.

Brug

Følgende funktioner er blevet indstillet i dine brugerkontroller af din hørespecialist:

Brugerkontrol	Funktioner
Kort tryk (1 sekund)	
Langt tryk (3 sekunder)	
Tap kontrol	

Vidste du, at du også kan styre dine høreapparater med din mobiltelefon eller andre smarte enheder?

Se vejledningen "Opsætning af Min App" for flere informationer.

Telefonopkald og høreapparater

Dine høreapparater er designet til modtage opkald fra din mobiltelefon eller fastnettelefon.

- **Fastnettelefon**

Kontakt din hørespecialist, hvis du ønsker at bruge din fastnettelefon med høreapparater på.

Hørespecialisten kan tilføje et "telefon" program i dine høreapparater.

Brug

• Mobiltelefon

For at streame telefonopkald til dine høreapparater, skal din smartphone forbindes til dine høreapparater. Se den medfølgende guide **Opsætning af Min App** som viser, hvordan du forbinder din smartphone med dine høreapparater.

Spørgsmål? Kontakt din hørespecialist.

Pleje af Høreapparat

Hold høreapparatet rent. Varme, fugt og fremmedlegemer kan resultere i dårlig ydeevne.

1. Brug aldrig vand, opløsningsmidler, rengøringsvæsker eller olie til at rengøre høreapparatet. Skil ikke apparaterne ad, eller forsøge at putte rengøringsredskaberne ind i dem.
2. Brug rengøringsredskaberne, der er inkluderet i din oplader, til at børste eller tørre snavs af mikrofonen, voksfILTERET og opladningskontakterne.
3. Tør dine høreapparater af hver dag. Hold dem over en blød klud eller lignende for at undgå skader hvis du taber dem.

Kontakt din hørespecialist for yderligere oplysninger om flere vedligeholdelsesprocedurer for høreapparatet.

Pleje af Høreapparat

Hjælpsomme råd

Når du ikke bruger apparaterne, bør du opbevare dem i opladeren, og opbevare denne:

- På et tørt, sikkert sted.
- Væk fra direkte sollys og ekstreme temperaturer.
- Et sted, hvor du nemt kan finde dem.
- Uden for børn og kæledyrs rækkevidde.

Kontakt din hørespecialist for flere råd.


Pleje af Høreapparat

Udskiftning af voksfILTERET


VoksfILTERET forhindrer akkumulering af ørevoks i høreapparatets modtagerdel. Skift filteret, hvis du oplever dårlig lydkvalitet.

Sådan skifter du voksfILTERET:

1. Før den tomme ende af pinden ind i det brugte filter.




2. Træk udad uden at dreje pinden, for at fjerne det brugte filter.




Pleje af Høreapparat

- Brug den modsatte ende til at indføre det nye filter.

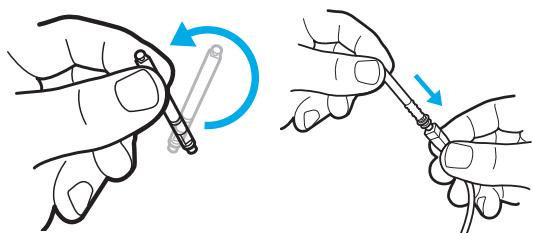

- Træk udad uden at dreje pinden.
Færdig!




Pleje af Høreapparat

Udskiftnings af Øreprop


Det er en god ide at skifte din øreprop regelmæssigt eller hvis dine ørepropper er løse, deformé eller misfarvede. En ændring i lydkvaliteten kan også være et tegn på, at du bør udskifte dine ørepropper.

Sådan fjerner du øreproppe:

- Træk den gamle tip fra receiveren.

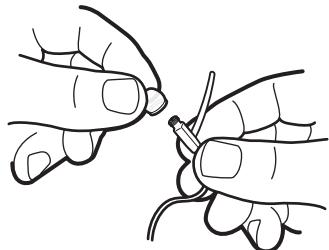


- Hold ledningen, hvor den møder receiveren.




Pleje af Høreapparat


3. Isæt receiveren præcis i midten af den nye tip.



4. Tryk den godt fast for at sikre, at tippen sidder fast på receiveren.



5. Sørg for, at tippen dækker gevindet på receiveren. Færdig!



Fejlfinding

Fejlfinding

Hvis dit høreapparat af en eller anden grund ikke fungerer korrekt, skal du IKKE forsøge at reparere det selv. Det er ikke blot sandsynligt, at du ugyldiggør eventuelle gældende garantier eller forsikringer, du kan også let forårsage yderligere skader.

Se mulige løsninger i vejledningen på side 32-34, hvis høreapparatet fejlfungerer eller fungerer dårligt.

Kontakt hørespecialisten for at få råd og hjælp, hvis problemerne fortsætter.

Mange almindelige problemer kan løses med det samme på hørespecialistens kontor eller klinik.

Symptom	Mulige årsager	Løsninger
Ikke tilstrækkelig høj lyd.	Blokeret øreprop/øresnegl.	1. Rengør dine høreapparater. 2. Udskift voksfILTERET efter behov.
	Ansamling af snavs.	Rengør mikrofonen og receiveren med en børste.
	Ændret hørelse.	Kontakt din hørespecialist.

Fejlfinding

Symptom	Mulige årsager	Løsninger
Inkonsistent ydeevne.	Blokeret øreprop/øresnegl.	1. Rengør dine høreapparater. 2. Udskift voksfILTERET efter behov.
	Genstart høreapparatet.	1. Placér dine høreapparater i opladeren. 2. Fjern dine høreapparater, når opladningen begynder. Dette genstarter apparaterne.
Uklar og forvrænget ydeevne.	Blokeret øreprop/øresnegl.	1. Rengør dine høreapparater. 2. Udskift voksfILTERET efter behov.
	Genstart høreapparatet.	1. Placér dine høreapparater i opladeren. 2. Fjern dine høreapparater, når opladningen begynder. Dette genstarter apparaterne.
	Defekte høreapparater.	Kontakt din hørespecialist

Fejlfinding

Symptom	Mulige årsager	Løsninger
Virker ikke	Blokeret øreprop/øresnegl	1. Rengør dine høreapparater. 2. Udskift voksfILTERET efter behov.
	Lavt batteri. Oplad høreapparatet	Placér dine høreapparater i opladeren, indtil opladerens indikatorlys skifter fra at blinke grøn til at lyse grøn.
	Defekt tyndslange	Kontakt din hørespecialist.
	Tyndslangen er ikke tilkoblet dine høreapparater.	Fjern tyndslangen fra høreapparatet og indsæt igen.
Høreapparaterne hyler i opladeren.	Høreapparaterne er ikke placeret korrekt i opladeren.	1. Fjern dine høreapparater fra opladeren. 2. Placer dine høreapparater tilbage i opladeren.
	Opladeren skal rengøres.	1. Fjern dine høreapparater fra opladeren. 2. Rengør opladeren med børsten, som er i opladeræsken. 3. Placer dine høreapparater tilbage i opladeren.

Yderligere vejledning

- Anvendelsesformål
- FCC information
- Regulatory information

Anvendelsesformål

ANVENDELSESFØRMÅL:

Et høreapparat med luftledning er en bærbar lydfør stærkende enhed, der er beregnet til at kompensere for nedsat hørelse.

Høreapparater leveres i mange forstærkningsgrader, der passer til behandling af høretab fra let til svært.

Høreapparaterne er designet til at fungere i offentlige miljøer og boligmiljøer og er designet til at overholde internationale emissions- og immunitets standarder for elektromagnetisk kompatibilitet for medicinsk udstyr.

Det er dog stadig muligt, at du kan opleve interferens forårsaget af forstyrrelser i stærkstrømsledninger, metaldetektorer i lufthavne, elektromagnetiske felter fra andet medicinsk udstyr, radiosignaler og elektrostatiske udladninger.

Hvis du anvender andet medicinsk udstyr eller har medicinske implantater som f.eks. defibrillatorer eller pacemakere og er bekymret over, om dine høreapparater kan interFERERE med dit medicinske udstyr, bedes du kontakte din læge eller producenten af dit medicinske udstyr for at få oplysninger om risikoen for interferens.

Du må ikke have høreapparaterne på under en MR-scanning eller i et hyperbarisk kammer.

Høreapparaterne er klassificeret som en type B anvendt del under IEC 60601-1 standarden for medicinsk udstyr.

Høreapparaterne er ikke fuldt certificerede til at fungere i eksplasive atmosfærer, som kan forekomme i kulminer eller visse kemiske fabrikker.

 Høreapparaterne skal opbevares inden for temperatur- og fugtighedsområder fra -4°C (-40°F) til $+60^{\circ}\text{C}$ (140°F) og 10–95 % relativ fugtighed (rH), og 70 kPa – 106 kPa (svarende til højder fra 1.200 ft (380 m) under havets overflade til 10.000 ft (3.000 m)).

Høreapparaterne er designet til at fungere ud over de temperaturområder, der er behagelige for dig, fra høj kulde op til 50°C (122°F).

ADVARSEL:

- Hvis produktet er varmt, rør det ikke, før det er afkølet.
- Hvis produktet ikke virker, må du ikke skille det ad. På grund af risiko for sted, bedes du sende det til reparation.
- Hold produktet utilgængeligt for børn. Indtag ikke noget fra emballagen, herunder tørremiddel, rengøringsværktøj osv.

Klinisk fordel

Høreapparatet er designet til at give bedre taleforståelse for at hjælpe med atlette kommunikationen med det formål at forbedre livskvaliteten.

Anvendelsesformål

Resume af kliniske undersøgelser

En klinisk undersøgelse, der inkluderede voksne over 18 år med mildt til svært høretab, vurderede ydeevnen og fordelene ved høreapparater. Brugerne gennemførte forskellige laboratorie- og feltundersøgelser i 2-6 uger for at afgøre, om apparaterne opfyldte de kliniske forventninger. Resultaterne af undersøgelsen bekræfter, at apparaterne giver forstørrelse, der er passende for brugernes høretab, og at brugeren oplever fordele ved forstørrelsen i overensstemmelse med normative data. Der blev ikke registreret alvorlige eller varige bivirkninger i løbet af undersøgelsen.

Anvendelse i fly

De trådløse funktioner, som dine høreapparater kan indeholde, kan anvendes ombord på et fly, da høreapparater er undtaget fra reglerne, der gælder for andre personlige elektroniske apparater ombord på et fly. Din smartphone skal sættes i **flytilstand** eller slukkes.

ÅBEN IKKE HØREAPPARATET, INGEN DELE INDENI ER BEREGNET TIL BRUGERREPARATION

Multiflex Tinnitus-information til hørespecialisten

Multiflex Tinnitus er et værktøj til at generere lyde, der skal bruges i et Tinnitus Management Program for patienter med tinnitus. Målgruppen er primært den voksne befolkning over 18 år.

Multiflex Tinnitus Teknologi er rettet mod hørespecialister, der behandler patienter med tinnitus såvel som konventionelle høretab. Tilpasningen af Multiflex Tinnitus skal udføres af en hørespecialist, der har deltaget i et Tinnitus Management Program.

MULTIFLEX TINNITUS TEKNOLOGI

Multiflex Tinnitus Teknologi er en funktion, der genererer lyde, som er programmeret ind i høreapparatet. Høreapparatet kan bruges i en af tre driftsformer: som høreapparat, som tinnitusbehandlingsinstrument eller som høreapparat og tinnitusbehandlingsinstrument.

Når den er aktiveret, genererer Multiflex Tinnitus-teknologien lyden og gør det muligt for hørespecialisten at tilpasse indstillingen til den individuelle behov.

Multiflex Tinnitus Teknologi genererer hvid bredbåndsstøj, der varierer i frekvens og amplitude. Disse karakteristika kan justeres af hørespecialisten.

Anvendelsesformål

Høreapparatbrugeren kan have en vis kontrol over signalets niveau eller lydstyrke, og brugeren bør drøfte denne justering samt hans eller hendes komfortniveau og lyden af signalet med hørespecialisten.

⚠ ADVARSEL: Hvis høreapparaten er indstillet til det maksimale output-niveau og bæres i perioder, der overstiger anbefalingerne nedenfor, kan brugeren eksponere for lydenergi potentieligt overskride støjeksponeringens grænserne. Dette høreapparat er beregnet til bruk i høyest seksten (16 timer om dagen, når det er indstillet til det maksimale output-niveau).

For høreapparatbrugeren

Tinnitus terapi instrument er et elektronisk instrument, der er beregnet til at generere støj med en tilstrækkelig intensitet og båndbredde til at behandle tinnitus. Det kan også anvendes som en hjælp til at høre eksterne lyde og tale.

TINNITUS TERAPI - KONCEPT OG FORDELE

Multiflex Tinnitus Teknologi kan bruges som et led i behandlingen af tinnitus.

Multiflex Tinnitus Teknologi spiller hvid støj gennem høreapparatet. Multiflex Tinnitus Teknologi er programmeret efter dit høretab og din præferencer, og din hørespecialist kan justere på lyden, så den passer til dig.

Multiflex Tinnitus Teknologi kan give en midlertidig lindring af din tinnitus.

⚠ ADVARSEL: Hvis høreapparaten er indstillet til det maksimale output-niveau og bæres i perioder, der overstiger anbefalingerne nedenfor, kan brugeren eksponere for lydenergi potentieligt overskride støjeksponeringens grænserne. Dette høreapparat er beregnet til bruk i høyest seksten (16 timer om dagen, når det er indstillet til det maksimale output-niveau). Du bør heller ikke bruge dit høreapparat, hvis din hørespecialist har indstillet det til niveauer, der overstiger dit komfortniveau.

Anvendelsesformål

Vigtige oplysninger til potentielle lydgeneratorbrugere

Et individ med tinnitus bør altid undersøges af en fagperson før en lydgenerator anvendes. En øre-næse-hals læge ville være at foretrække. Årsagen til denne anbefaling er, at man bør sikre at alle medicinske tilstande er identificerede og behandlede før lydgeneratoren bruges.

TEKNISK DATA FOR TINNITUS

Maksimalt output for Multiflex-tinnitus teknologi = 87 dB SPL (typisk) ved måling i en 2cc coupler-anordning ifølge ANSI S3.22 eller IEC 60118-7.

TEKNISK BESKRIVELSE AF TRÅDLØS TELEGRAFI

Dit høreapparat indeholder en radiomodtager, der bruger Bluetooth® og fungerer i 2.4-2.4835 GHz frekvensbåndet med en maksimal effektiv strålingseffekt på -1 dBm med transmissionsmodulationstype GFSK. Modtagersektionen af radioen har en båndbredde på 15MHz. RIC 312 indeholder også en radiomodtager, som anvender "Near Field Magnetic Induction" og fungerer ved 10.281 MHz med en maksimal induceret magnetisk feltstyrke på -5 dBuA/m ved en måleafstand på 10 meter med transmissionsmodulationstype 8-DPSK. RIC 312-modtagerdelen af NFMI-radioen har en båndbredde på 400 kHz.

Denne høreapparatmodel er testet for og har bestået følgende emissions- og immunitetstests:

- IEC 60601-1-2 udstrålingskrav for en gruppe 1 klasse B-anordning som angivet i CISPR 11.
- Udstrålet RF-immunitet ved et feltniveau på 10 V/m mellem 80 MHz og 2,7 GHz tillige med højere feltniveauer fra kommunikationsudstyr som angivet i tabel 9 i IEC 60601-1-2.
- Immunitet over for strømfrekvensmagnetfelter ved et feltniveau på 30 A/m.
- Immunitet over for ESD-niveauer på +/-8 kV foretaget udladning og +/-15 kV luftudledning.

The expected service life is 3 years.

Intended use

WIRELESS NOTICES

mRIC R:
FCC ID: EOA-24GENMICRO
IC: 6903A-24GENMICRO

RIC RT:
FCC ID: EOA-24GENMACRO
IC: 6903A-24GENMACRO

EU - indrapportering af alvorlige hændelser

Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med dit Starkey-apparat, skal rapporteres til din lokale Starkey forhandler. En alvorlig hændelse defineres som enhver funktionsfejl, forringelse af enhedens egenskaber og/eller ydeevne eller utilstrækkelighed i brugervejledningen, der kan føre til døden eller alvorlig forringelse af brugerens helbred.

FCC information

Disse enheder overholder del 15 af FCC-reglerne og ISED Canadas licensfri RSS-standarder. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.

BEMÆRK: Producenten er ikke ansvarlig for radio- eller tv-interferens forårsaget af uautoriserede ændringer af dette udstyr. Sådanne ændringer kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

Herved erklærer Starkey Laboratories, Inc., at RIC R og RIC RT overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 2014/53/EU. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan fås på adressen nedenfor eller på docs.starkeyhearingtechnologies.com.

Herved erklærer Starkey Laboratories, Inc., at RIC R og RIC RT overholder UK Radio Equipment Regulations SI 2017, som ændret. En kopi af den britiske overensstemmelseserklæring kan fås på følgende adresser og på docs.starkeyhearingtechnologies.com.

Regulatory information

For service or repair, please contact your hearing care professional first. If necessary, you can send your hearing aids to:

 **Starkey Laboratories, Inc.**
6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 USA
www.starkey.com

EC REP

Starkey Laboratories (Germany) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hamburg
Germany

UK Authorised Person:
Starkey UK
William F. Austin House
Pepper Rd, Hazel Grove
Stockport SK7 5BX, UK
www.starkey.co.uk

 Waste from electronic equipment must be handled according to local regulations

 Consult user manual

 Keep dry

Instructions for Disposal of Old Electronics

Starkey Laboratories, Inc. encourages, the EU requires, and your local community laws may require, that your hearing aids be disposed of via your local electronics recycling/disposal process.

The instructions below are provided for the benefit of disposal/recycling personnel. Please include this manual when disposing of your hearing aids.

FOR DISPOSAL/RECYCLING PERSONNEL ONLY

These products contains a Lithium Ion Polymer battery. For instructions on removing the battery from the hearing aids, please visit <https://web.starkeypro.com/conformity/regulatory-information.html>.

Regulatory information

Symbol	Symbol Meaning	Applicable Standard	Symbol Number
	Manufacturer	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.1
	Authorized representative in the European Community	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.2
	Date of Manufacture	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Catalogue Number	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.6
	Serial Number	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.7
	Medical Device	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.7
	Keep Dry	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.4
	Temperature Limit	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.7
	Humidity Limitation	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.8
	Caution	BS EN ISO 15223-1:2021	5.4.4
	General warning sign	EC 60601-1, Reference no. Table D.2, Safety sign 2	ISO 7010-W001
	Refer to instruction manual/booklet	EC 60601-1, Reference no. Table D.2, Safety sign 10	ISO 7010-M002
	Collect Separately	DIRECTIVE 2012/19/EU (WEEE)	Annex IX
	Class II equipment	IEC 60417 Reference no. Table D.1	Symbol 9 (IEC 60417-5172)
	Regulatory Compliance Mark (RCM)	AS/NZS 4417.1:2012	N/A
	Giteki Mark	Japanese Radio Law	N/A
	Direct current	IEC 60601-1 Reference no. Table D.1	IEC 60417-5031
	Recycling Symbol	European Parliament and Council Directive 94/62/EC	Annex I-VII

Notes



Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, the Apple logo, iPhone, iPad and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Google Play is a trademark of Google LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Starkey is under license. Genesis, Starkey, and StarLink are trademarks of Starkey Laboratories, Inc.